

Концентратор РГТ-КИТМ-00

Разъём для кабеля Ethernet


Вид спереди

Разъём для USB кабеля

Разъём для измерителя температуры многозонного РГТ-ИТМ2 (8 шт.)

Разъём для кабеля RS-485

Разъём для кабеля RS-485

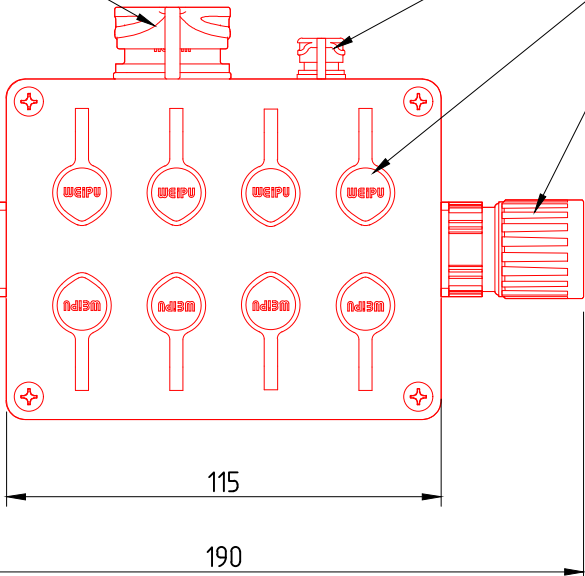


Вид сбоку

Разъём для кабеля Ethernet

Разъём для измерителя температуры многозонного РГТ-ИТМ2 (8 шт.)

Разъём для кабеля RS-485

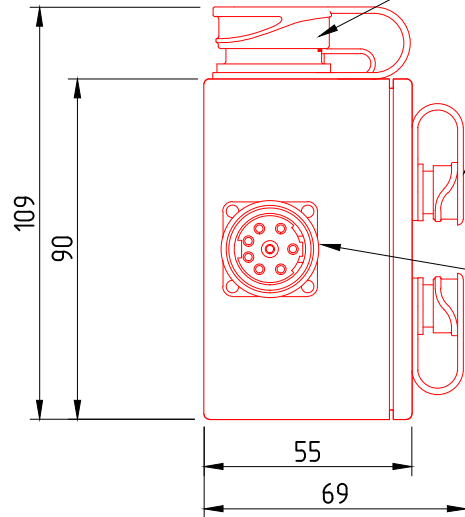


Разъём для кабеля Ethernet

Вид сверху

Разъём для USB кабеля

Разъём для кабеля RS-485

Разъём для кабеля RS-485

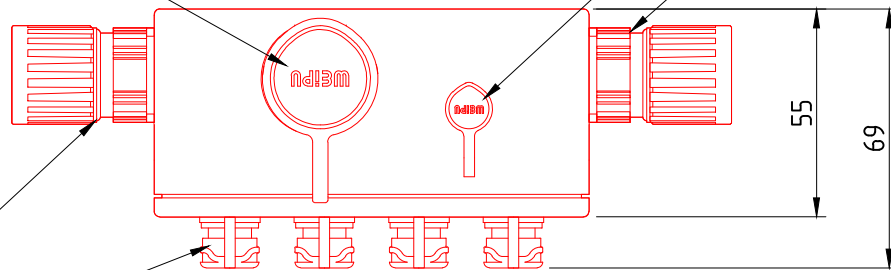

Разъём для измерителя температуры многозонного РГТ-ИТМ2 (8 шт.)

РГТ-КИТМ-00 с подключенными угловыми разъёмами кабеля RS-485

Кабель RS-485

19

Разъём типа M23DJ_TL

77

Разъём типа M23DJ_TL

Кабель RS-485

77

128


19

1:2

РГТ-КИТМ-00 с подключенными прямыми разъёмами кабеля RS-485

Разъём типа M23DJ_TK

Кабель RS-485

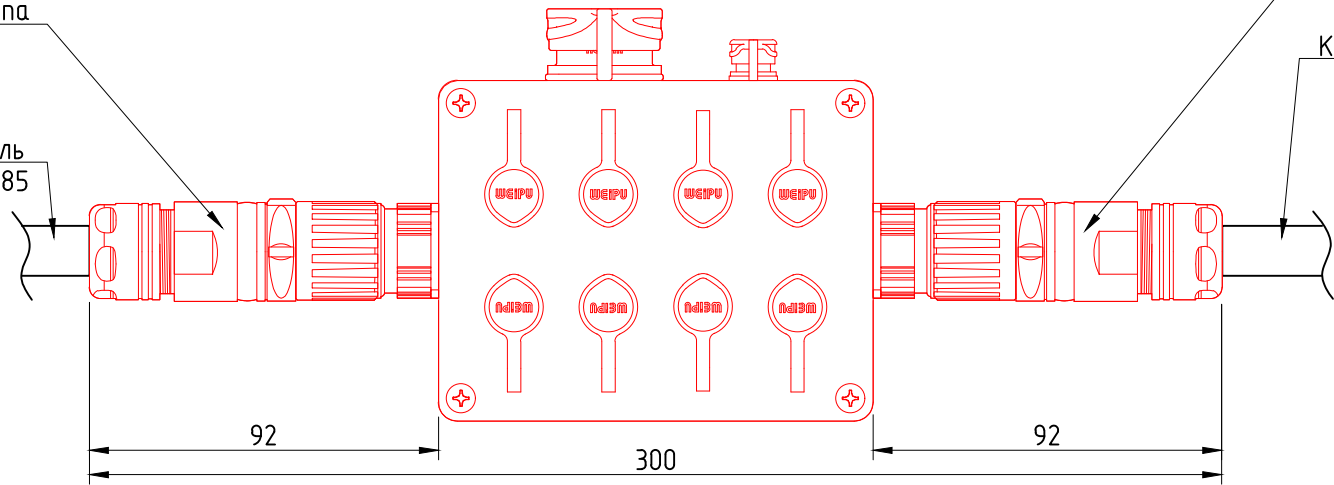

Разъём типа M23DJ_TK

Кабель RS-485

РГТ-АГТМ

Автоматизированная система мониторинга

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Шарков А.			04. 26
Проверил		Шарков А.			04. 26
Разраб.		Елисеев П.			04. 26
Н.контроль		Елисеев П.			04. 26

Справочная информация

Концентратор РГТ-КИТМ-00

Стадия	Лист	Листов
Р	-	1

